



LR avec Sage 100 V12

Confidentialité

C1 - Restreint

Paramétrage de Listes de Recherches - Compatibilité avec S100 V12

Date de mise à jour : 29/09/2025

Afin d'assurer la compatibilité de Listes de Recherches avec Sage 100 V12, il est nécessaire de procéder à un rapide paramétrage comme renseigné dans ce document.

Table des matières

1. Prérequis	3
2. Ouverture de la fenêtre de paramétrage	3
2.1. Si un raccourci vers Listes de Recherches est présent sur votre bureau	3
2.2. Si LR se lance automatiquement au démarrage du PC	3
3. Application du paramétrage	4

1. Prérequis

- Être en possession de LR Client v7.2.25.121.
- Assurez-vous que le programme n'est pas lancé, ou quittez-le.

2. Ouverture de la fenêtre de paramétrage

2.1. Si un raccourci vers Listes de Recherches est présent sur votre bureau


1. Rendez-vous sur votre bureau.
2. Sur votre raccourci LR, effectuez un clic droit, puis sélectionnez « Propriétés ».

2.2. Si LR se lance automatiquement au démarrage du PC

1. Effectuez un clic droit sur le menu démarrer dans la barre des tâches (logo Windows)
2. Cliquez sur « exécuter »




3. Tapez « shell:startup » puis cliquez sur « OK »

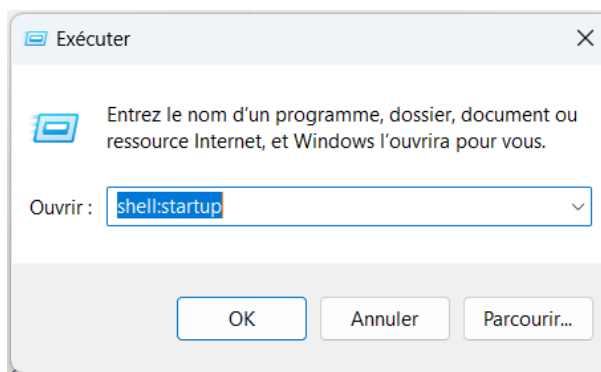

4. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, trouvez votre raccourci LR dans la liste. Effectuez un clic droit sur celui-ci, puis sélectionnez « Propriétés ».

3. Application du paramétrage

1. Assurez-vous d'être dans l'onglet « Raccourci »

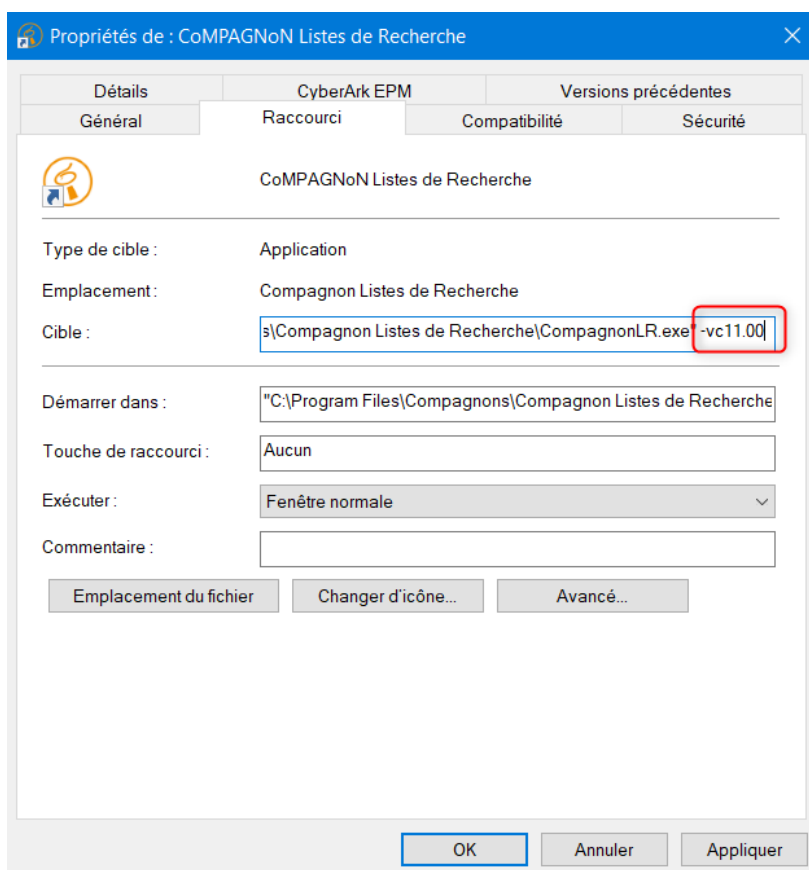

2. Rendez-vous à la fin du champ « Cible » et ajoutez « -vc11.00 »
3. Cliquez sur « OK ».
4. Vous pouvez relancer Listes de Recherche.